義手検査表　C　（前腕義手）

氏名　：　　（　　才）　　実地日　：　　性別：　□　男　　□　女

切断側：　□　右　　□　左　　検査者名：　　身長：　　cm　体重　　kg

項目	確認項目	基準・標準	check
仕様	□処方箋	・処方箋の仕様通り	⊗
	□ソケット　□手先具　□手継手 □肘継手　□ハーネス □コントロールケーブル部品		⊗

ハーネスの腋窩パッド	□腋窩パッドの取付け	・腋窩ループ：幅は腋窩を覆う大きさ	⊗

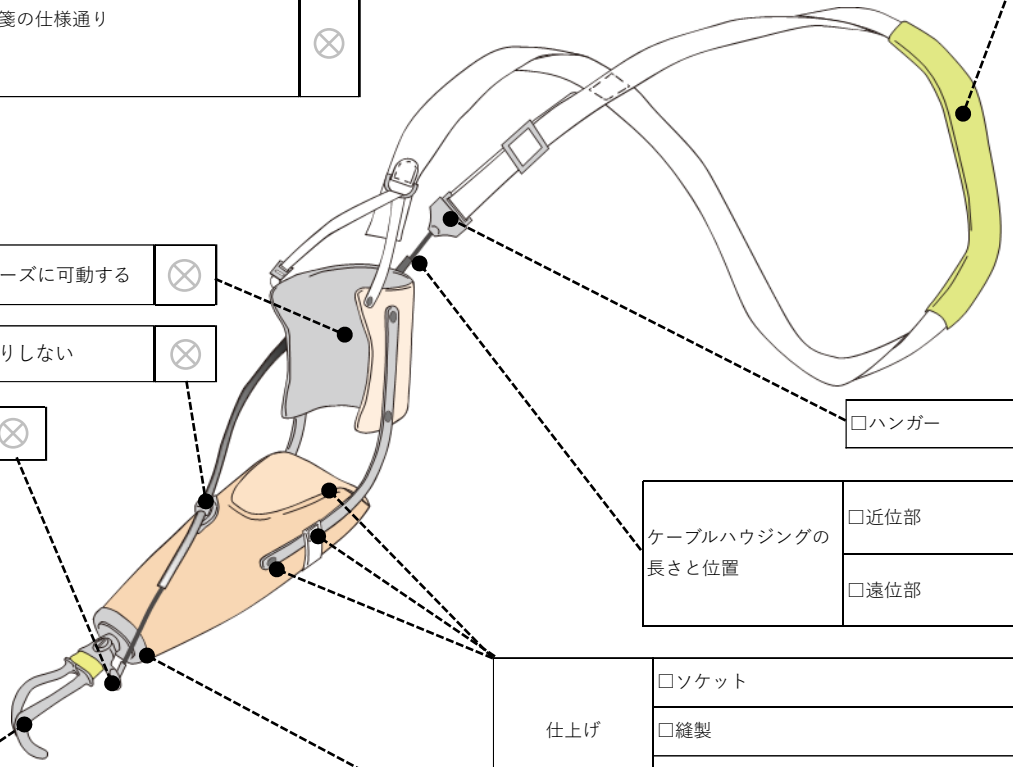

□クロスバーカバーの可動性	・走行に合わせて、スムーズに可動する	⊗
□ベースプレートの固定性	・ガタついたり、外れたりしない	⊗
□ボールターミナル	・遠位部：制御レバーに接続されている	⊗

□ハンガー	・近位部：ハーネスと接続されている	⊗

ケーブルハウジングの長さと位置	□近位部	・ハンガーと接触しない ・クリアランスは5～10㎜	⊗
	□遠位部	・ボールターミナルと干渉しない ・クリアランスは5～10㎜	⊗

仕上げ	□ソケット	・滑らかである	⊗
	□縫製	・しっかり縫えている	⊗
	□リベット	・突出や引っ掛かりがない	⊗

手継手	□固定性	・ケーブルを牽引しても回らない	⊗
	□可動性	・手動で回旋できる	⊗

手先具	□可動性	・滑らかに全開大して戻る	⊗

義手の長さ	□義手長	cm	・設定通りである	⊗
義手の重さ	□重さ	g	・標準値を参考にする	⊗

Checkout Chart of Body-powered Upper Limb Prosthesis -Japanese version- Checkout Chart for Upper Limb Prosthesis (Transradial Prosthesis) © 2024 by The Japanese Society of Prosthetics and Orthotics is licensed under CC BY-ND 4.0

義手検査表　C　（上腕義手）

氏名　：　　（　　才）　　実地日　：　　性別：　□　男　　□　女

切断側：　□　右　　□　左　　検査者名：　　身長：　　cm　体重　　kg

項目	確認項目	基準・標準	check
仕様	□処方箋	・処方箋の仕様通り	⊗
	□ソケット　□手先具　□手継手 □肘継手　□ハーネス □コントロールケーブル部品		⊗

ケーブルハウジングの長さと位置	□近位部	・ハンガーと接触しない ・クリアランスは5～10㎜	⊗
	□遠位部	・ボールターミナルと干渉しない ・クリアランスは5～10㎜	⊗

ハーネスの腋窩パッド	□腋窩パッドの取付け	・腋窩ループ：幅は腋窩を覆う大きさ	⊗

仕上げ	□ソケット	・滑らかである	⊗
	□縫製	・しっかり縫えている	⊗
	□リベット	・突出や引っ掛かりがない	⊗

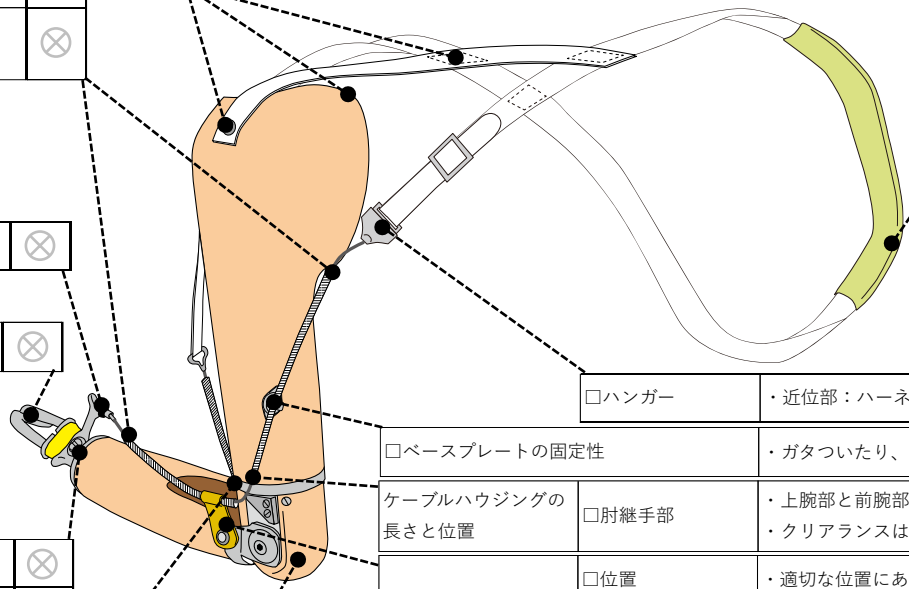

□ボールターミナル	・遠位部：制御レバーに接続されている		⊗

手先具	□可動性	・滑らかに全開大して戻る	⊗

□ハンガー	・近位部：ハーネスと接続されている		⊗
□ベースプレートの固定性	・ガタついたり、外れたりしない		⊗
ケーブルハウジングの長さと位置	□肘継手部	・上腕部と前腕部が接触しない ・クリアランスは5～10㎜	⊗
リフトレバー	□位置	・適切な位置にあるか	⊗
	□可動性	・走行に合わせて、スムーズに可動する	⊗

手継手	□固定性		・ケーブルを牽引しても回らない	⊗
	□可動性		・手動で回旋できる	⊗
ターンテーブル	□固定性	kg	・ケーブルを牽引したときに回旋しない	⊗
	□可動性		・手動で回旋できる	⊗
義手の長さ	□義手長	cm	・設定通りである	⊗
義手の重さ	□重さ	g	・標準値を参考にする	⊗

肘継手の屈曲可動域	□屈曲角度	度	・135度以上の可動域がある	⊗
肘屈曲に必要な力	□要する力④	kg	・4,5kg以内である	⊗
肘継手の動作確認	□ロック・アンロックの切替え動作の操作性		・滑らかな切替えができる	⊗

Checkout Chart of Body-powered Upper Limb Prosthesis -Japanese version- Checkout Chart for Upper Limb Prosthesis (Transhumeral Prosthesis) © 2024 by The Japanese Society of Prosthetics and Orthotics is licensed under CC BY-ND 4.0